


DISPENSADOR DE BOLSAS HIGIÉNICAS

Estándard



AI0920C
Acabado brillante

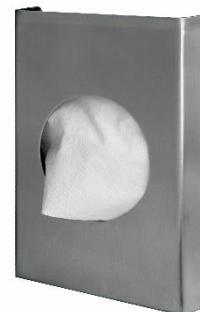

AI0920CS
Acabado satinado

Descripción general

- Dispensador de bolsas higiénicas unitario, diseñado para ser adosado a la pared o para su instalación en sobremesa, fabricado en acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm de espesor.
- Sistema de eliminación sanitaria discreto y cómodo. Higiénicamente recomendable y necesario.
- Dispensación de bolsas frontal, a través de orificio central.
- Requiere como consumible cajita de cartón con capacidad aproximada para 25 bolsas higiénicas y dimensiones 126 x 86 x 17 mm.
- De fácil limpieza, mantenimiento y recarga.
- Se suministra con todos los elementos necesarios para ser instalado en la pared.


Componentes y materiales

- **AI0920C:** dispensador de bolsas higiénicas unitario fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor y acabado brillante.
- **AI0920CS:** dispensador de bolsas higiénicas unitario fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor y acabado satinado.
- **CUERPO:** de acero inoxidable AISI 304 y 0,8 mm de espesor. Unido a la pletina posterior de anclaje a la pared por medio de soldadura.
- **PLETINA DE FIJACIÓN A LA PARED:** de acero inoxidable AISI 304 y 0,8 mm de espesor. Dispone de un coliso horizontal para tornillo superior y de un agujero oval para tornillo inferior, para fijar el dispensador a la pared.

Especificaciones técnicas

Dimensiones generales	<i>136 x 91 x 24 mm</i>
Espesor cuerpo y pletina	<i>0,8 mm</i>
Dimensiones caja bolsas higiénicas	<i>126 x 86 x 17 mm</i>
Peso (vacío)	<i>0,2 Kg</i>

Dimensiones

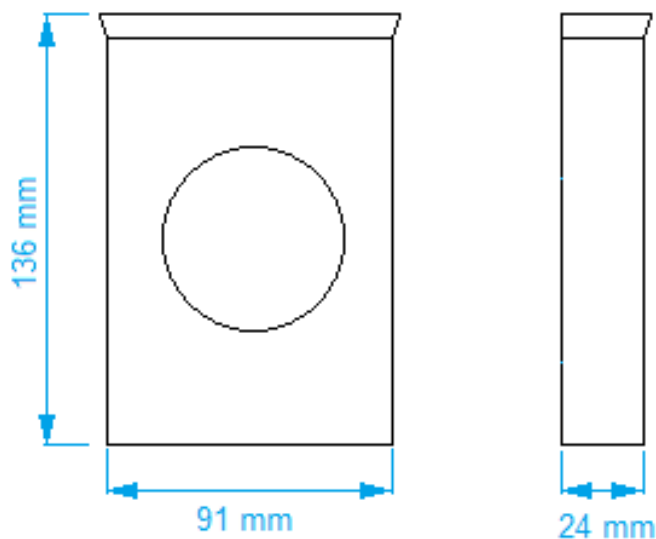


Dimensiones: ± 4%

Montaje

Alturas recomendadas de instalación

Fijar la pletina de anclaje a la pared, a la altura deseada, utilizando los tornillos suministrados y teniendo en cuenta las distancias de los puntos indicados por una "S" en la figura siguiente:

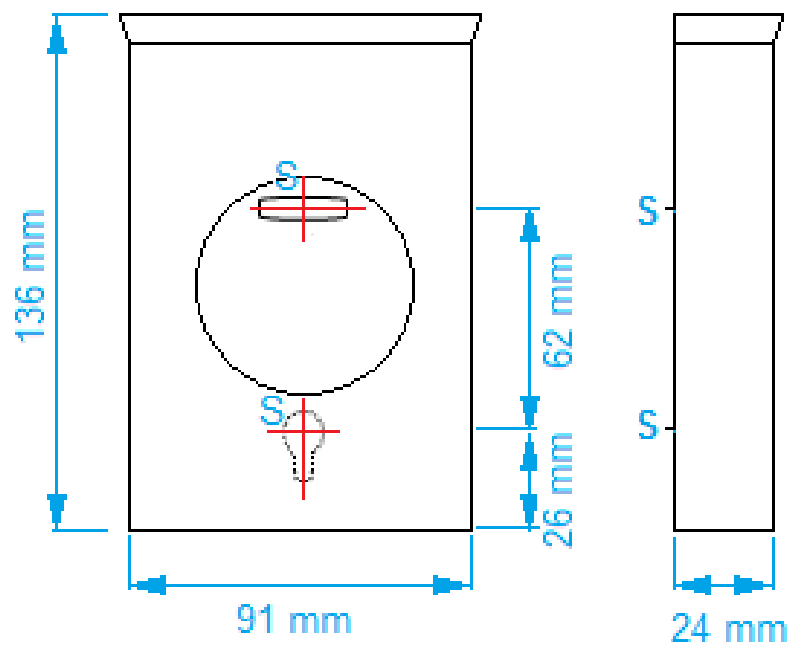

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso
Revisión 08-18 © mediclinics S.A.

